

Дом здравља „Врачар“
Бојанска бр. 16
Број:02/1416/17
Датум: 15.12.2016. године
Број јавне набавке ЈН 4-2016

Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 4-2016 за набавку добара –
Набавка медицинске опреме обликована по партијама – Измена бр. 4

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације за ЈН 4-2016, у складу са наводима из Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.
Како би понуђачи могли да припреме одговарајуће и упоредиве понуде врши се измена конкурсне документације на следећи начин:

1) на страни 4 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 3. додавањем речи „pinless“ и сада гласи:

3.3 активна једнака " pinless " прикључка за сонде.

2) на страни 4 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 5. додавањем текста минимум 8,9 inch-аи сада гласи:

5.Контролни екран осетљив на додир минимум 8,9 inch-а

3) на страни 4 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 6. додавањем и изменом текста сада гласи:

6.Хардверска алфанумеричка тастатура на самој конзоли апарата или на извлачење

4) на страни 4 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 10. додавањем текста за линеарну и вагиналну сонду и сада гласи:

10. Сонде:

- конвексна сонда, приближног опсега 1.0 - 8.0 MHz

- Линеарна сонда, приближног опсега 3.0 - 13.0 MHz, ширине минимум 45 mm, минимум 192 кристална елемента са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди

- Вагинална сонда, приближног опсега 4.0 - 9.0 MHz, минимално видно поље сонде 145°, са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди

1) на страни 16 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 3. додавањем речи „pinless“ и сада гласи:

3.3 активна једнака " pinless " прикључка за сонде.

2) на страни 16 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 5. додавањем текста минимум 8,9 inch-аи сада гласи:

5.Контролни екран осетљив на додир минимум 8,9 inch-а

3) на страни 16 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 6. додавањем и изменом текста сада гласи:

6.Хардверска алфанумеричка тастатура на самој конзоли апарата или на извлачење

4) на страни 16 од 43 у оквиру Техничких спецификација за ултразвучни апарат са три сонде, измена се врши за тачку под рб 10. додавањем текста за линеарну и вагиналну сонду и сада гласи:

10. Сонде:

- конвексна сонда, приближног опсега 1.0 - 8.0 MHz

- Линеарна сонда, приближног опсега 3.0 - 13.0 MHz, ширине минимум 45 mm, минимум 192 кристална елемента са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди

- Вагинална сонда, приближног опсега 4.0 - 9.0 MHz, минимално видно поље сонде 145°, са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди

Измењене стране конкурсне документације 4 и 16 налазе се у саставу овог документа.


Измењене стране конкурсне документације су обележене текстом „Измена бр. 4“ у горњем десном углу стране.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Измену конкурсне документације – Измену број 4.

Овај документ представља саставни део конкурсне документације

С'поштовањем,

Комисија за јавну набавку ЈН 4-2016

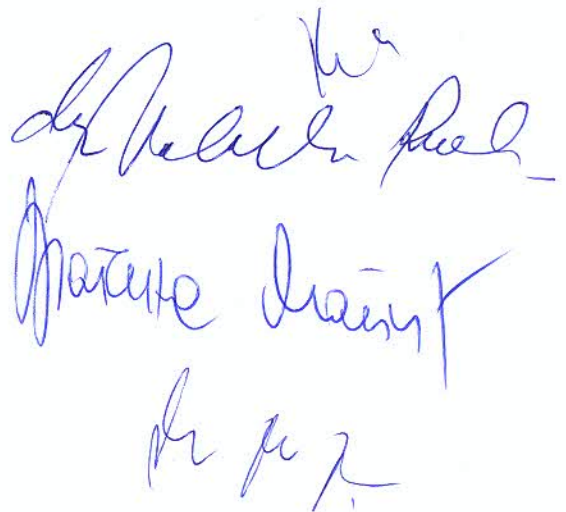

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

*Техничке карактеристике-Спецификација захтеваних добара- медицинске опреме која је предмет јавне набавке број 4-2016

ПАРТИЈА 1 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ТРИ СОНДЕ

Ред број	Назив	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Ултразвучни апарат са три сонде	ком	1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ТРИ СОНДЕ

1. Стационарни колор доплер ултразвучни апарат
2. Примена апарата у области радиологије, гинекологије и акушерство, педијатрије,
3. 3 активна једнака ''pinless'' прикључка за сонде
4. Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 19", могућност померања у више праваца: горе/доле, десно/лево и напред/назад независно од контролног панела
5. Контролни екран осетљив на додир минимум 8,9 inch-a
6. Хардверска алфанумеричка тастатура на самој конзоли апарата или на извлачење
7. Диск од минимум 500GB, 5 USB портова, интегрисан DVD резач
8. Интегрисани или екстерни грејач гела
9. Црно/бели термални принтер
10. Сонде:
 - конвексна сонда приближног опсега, 1.0-8.0 MHz
 - линеарна сонда, приближног опсега 3.0-13.0 MHz, ширине минимум 45 mm, минимум 192 кристална елемената са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди
 - вагинална сонда, приближног опсега 4.0-9.0 MHz, минимално видно поље сонде 145° са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди
11. Динамички опсег од минимум 250 dB у В и М моду. Ниво динамичког опсега са приказом на апарату са сондама.
12. Фреквенца освежавања слике минимално 1800 f/s (Hz)
13. Максимална дубина приказа минимум 36 cm
14. цине меморија минимум 256 MB
15. Модови рада; В, М, колор доплер, PW доплер, CW доплер, Power doppler, TMI , Triplex, приказ спорих протока
16. Аутоматска оптимизација слике у В моду и опсега брзине и скале у PW доплеру притиском на једно дугме
17. Могућност увећања слике без губитка дијагностичког квалитета и повећања гранулације слике у реалном времену
18. Интегрисана опција појачања јасноће контура-ивица, појачање осветљења, контраста

Назив понуђача: _____
 Седиште понуђача: _____
 Матични број понуђача: _____
 ПИБ: _____
 Текући рачун понуђача: _____
 Број Тел/Факс: _____
 Место и датум: _____
 Јн 4-2016

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 1 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ТРИ СОНДЕ

Ред број	Назив	Јед мере	Количина	Произвођач	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8=(4x6)
1.	Ултразвучни апарат са три сонде	ком	1				
						Износ ПДВ-а:	
						Укупна цена са ПДВ-ом:	

Напомена:

У цену укалкулисати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Техничка спецификација – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ СА ТРИ СОНДЕ

1. Стационарни колор доплер ултразвучни апарат
2. Примена апарата у области радиологије, гинекологије и акушерство, педијатрије,
3. 3 активна једнака 'pinless' прикључка за сонде
4. Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 19", могућност померања у више праваца: горе/доле, десно/лево и напред/назад независно од контролног панела
5. Контролни екран осетљив на додир минимум 8,9 inch-а
6. Хардверска алфанумеричка тастатура на самој конзоли апарата или на извлачење
7. Диск од минимум 500GB, 5 USB портова, интегрисан DVD резач
8. Интегрисани или екстерни грејач гела
9. Црно/бели термални принтер
10. Сонде:
 - конвексна сонда приближног опсега, 1.0-8.0 MHz
 - линеарна сонда, приближног опсега 3.0-13.0 MHz, ширине минимум 45 mm, минимум 192 кристална елемената са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди
 - вагинална сонда, приближног опсега 4.0-9.0 MHz, минимално видно поље сонде 145° са активном опцијом еластографије на понуђеној сонди